

Warszawa, 25.08.2023 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIAN TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę wyrobów medycznych, nr sprawy: PN-178/23/JP

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie nr 1

Pakiet 2, 4

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Pakiet 2, pozycja 1, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z trójwarstwowej włókniny typu SMS o wymiarach 70cm x 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet 2, pozycja 1, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły w rozmiarze 16x12,5x7,5 z polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Pakiet 2, pozycja 1, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową w rozmiarze 5x24,5x10 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Pakiet 2, pozycja 1, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150cm x 180cm z laminatu dwuwarstwowego? (owinięcie zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Pakiet 2, pozycja 2, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki 114cm x 150cm z dwuwarstwowego laminatu z zakładką o długości 25cm zintegrowaną torbą do zbiórki płynów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Pakiet 2, pozycja 2, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z trójwarstwowej włókniny typu SMS w rozmiarze 70cm x 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pakiet 2, pozycja 2, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm z dwuwarstwowego laminatu (owinięcie zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy z 2 etykietami do przyklejenia do dokumentacji medycznej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową PP+PE o gramaturze 60g/m², odporność na penetrację płynów 196cm H₂O, odporność na rozrywanie na sucho 110 kPa/ mokro 100 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 120cm x 90cm (owinięcie zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową przyklepną w rozmiarze 50cm x 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne ze stali nierdzewnej z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe PP+PE o gramaturze 60g/m², odporność na penetrację płynów 196cm H₂O, odporność na rozrywanie na sucho 110 kPa/ mokro 100 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową nieprzylepną w rozmiarze 45cm x 45cm?(owinięcie zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pęsetę metalową anatomiczną w rozmiarze 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe PP+PE o gramaturze 60g/m², odporność na penetrację płynów 196cm H₂O, odporność na rozrywanie na sucho 110 kPa/ mokro 100 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 50cm x 75cm w kolorze niebieskim (owinięcie zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50cm x 75cm z centralnym otworem przylepnym o wymiarach 6cm x 8cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści tupfer z gazy z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm, niebieskie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę 1,20 x 40mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,50 x 40mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Dot. części 8 – igły ze szlifem Hubera:

Czy Zamawiający dopuści igły ze szlifem Hubera z zabezpieczeniem przeciw samozakłuciu o następujących parametrach:

Igła gładka (bez karbowania), ze szlifem Hubera do długich przetoczeń:

- z przezroczystym drenem o długości min.20cm,
- z wygodnymi, sztywnymi i odpinanymi skrzydełkami,
- z korpusem wykonanym z przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia,
- z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta, z medycznej pianki, o grubości min. 4mm, zespolona z korpusem igły
- rozmiary 22 G (16mm, 19mm, 32mm) 20G (16mm, 19mm, 32mm) 19G (19mm, 25mm, 32mm)
- z kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku,
- z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci uchylnej dźwigni, sygnalizującej słyszalnym „kliknięciem” bezpieczną pozycję igły podczas jej wyjmowania
- dreny z PVC typu non-DEHP

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Część 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści tacka na płyny 14 x 24,5 x 5,0 cm, z polipropylenu - 2 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

2Projekt umowy, Par. 13, ust. 1.4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapłatę Zamawiającemu kar umownych w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej części Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Dot. części 8

Ze względu na bardzo dużą ilość zapotrzebowania igieł Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o rozważanie i dopuszczenie do postępowania igły bez zabezpieczenia za pomocą mechanizmu lecz przy użyciu osłonek jako wystarczającego zabezpieczenia przed samozakłuciem, takie rozwiązanie nadal spełnia swoją rolę użytkową i zabezpiecza personel przed samookaleczeniem w trakcie wyjmowania igły z opakowania- ponadto igły zużyte przechowywane są w specjalnie dedykowanych pojemnikach, zgoda na dopuszczenie igły w osłonie, ma znaczący wpływ na cenę produktu: igły z mechanizmem są droższe od 7- 10 zł od igieł wyposażonych tylko w osłonę zabezpieczającą, dla zamawiającego oznacza to niższy budżet przeznaczony na ten cel, przy czym zachowanie funkcjonalności Leczniczej danego produktu pozostaje niezmienna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Dot. części 8

prosimy o usunięcie igły 12 mm , taką igłę może dostarczyć tylko jeden wykonawca co jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji , igły 12 mm używa się sporadycznie lub wcale i można ją zastąpić igłą 15mm , prosimy wydzielenie do osobnego pakietu 12 mm lub wykreślenie tak by nie blokowała dostępu do postępowania innym wykonawcom taka decyzja zamawiającego umożliwi złożenie ofert w ramach konkurencyjności więcej niż jednemu wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia w części nr 8 opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2.8 do SWZ), w zakresie poniższych rozmiarów:

Było:

rozm 19 G dł igły 12 mm

rozm 19 G dł igły 15 mm

Jest:

rozm 19 G dł igły 12-15 mm

Powyższe zostanie uwzględnione w zmienionym załączniku nr 2.8 do SWZ.

Pytanie nr 29

Dot. części 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony pakowanej zgodnie z wymogiem ustawy o wyrobach medycznych. Posiadającej etykietę zawierającą numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób) oraz z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Dot. części 8

Czy Zamawiający w zadaniu 8 dopuści jednorazową bezpieczną igłą do portów z ostrzem Hubera do długich przetoczeń, zaopatrzoną w mechanizm zabezpieczający (dźwignia) przed zakłuciem personelu medycznego, umożliwiającą obsługę jedną ręką. Zastosowanie pozytywnego ciśnienia podczas wycofywania igły, ze skrzydełkami, zagięta pod kątem 90°, z przedłużeniem min. 20 cm PVC bez DEHP oraz lateksu z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock.

Igła z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta, z medycznej pianki o grubości 2mm, zespoloną z korpusem igły.

Możliwość podawania cytostatyków, wlewów, transfuzji, pobierania próbek krwi przez membranę portu. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym

Łatwa identyfikacja rozmiaru igły przez kolor zacisku typu Roberts.

W zestawie nieabsorbująca mała medyczna pianka do ustabilizowania igły.

Igły w rozmiarach: 19, 20, 22G długość 15,17,20,25,30,35 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Dot. części 5, Dotyczy Załącznika nr 2.5 do SWZ, Punkt 2

Pragniemy zaoferować Państwu znaczniki Tumark firmy Hologic (dawniej Somatex)

<https://www.somatex.com/en/tissue-marking/>


Oferowane przez nas znaczniki:

- Wykonane są z nitinolu
- Zapewniają bardzo dobrą widoczność w USG, RTG i MRI
- Zabezpieczone przed migracją - stabilność długoterminowa
- Cienkie 18G kaniule


- Ostra końcówka dobrze widoczna w ultradźwiękach
- Umieszczone w aplikatorze z podziałką 1cm
- Igła dostępna w 10cm lub 12cm długości
- Wyposażone w ergonomiczny rękojeść umożliwiającą obsługę jedną ręką
- Dostępne w różnych kształtach




Tumark Professional U

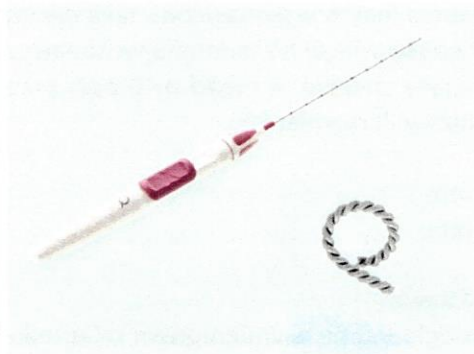

Tumark Professional Q

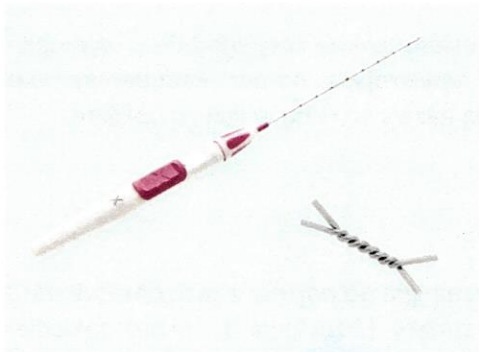


Tumark Professional X

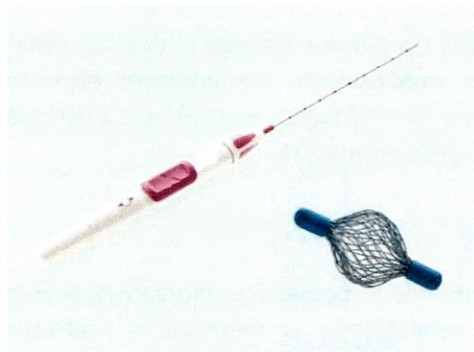

Tumark Vision (*premium marker*)

Tumark Vision - Unikalna konstrukcja 3D ze strukturą siatkową wykonaną z 48 pojedynczych drutów prowadzi do wysokiej echogeniczności

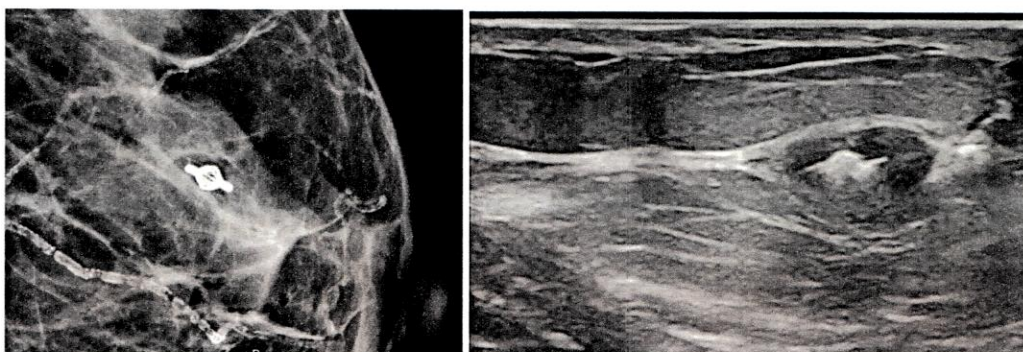

Prosimy o dopuszczenie znaczników opisanych jak powyżej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Dot. części 5, Dotyczy Załącznika nr 2.5 do SWZ, Punkt 2

W przypadku dopuszczenia znaczników opisanych w Pytaniu nr 1, prosimy o rozpakietowanie znaczników tkankowych jako osobna część postępowania. W swojej ofercie nie posiadamy igieł do biopsji gruboigłowej kompatybilnych z pistoletem Magnum. Obecne połączenie dwóch produktów (igieł oraz znaczników) w jednej części uniemożliwi nam złożenie oferty na znaczniki opisane w Pytaniu nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 4

W związku z obecną sytuacją polityczną w Europie oraz epidemiologiczną na świecie, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 14 dni roboczych.

Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne, ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia.

Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z wyżej wymienionych powodów mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach. Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez firmę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony. Należy pamiętać również o czasie transportu, który w przypadku poczty kurierskiej z zagranicy w obecnej sytuacji trwa nawet 10 dni roboczych.

W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 14 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Dotyczy wzoru umowy w § 13 pkt 1 ppkt 1) i 2)

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych w w/w punktach do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub niewymienionego towaru a każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Dot. części 4

Pozycja 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnych zestawów do dożylnego wkucia centralnego o wysokiej odporności na penetrację płynów min 158 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i mokro min. 134 kPa i posiadających w swoim składzie:

- 1 x imadło chirurgiczne 14 cm, wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" umieszczony w sposób trwały i widoczny po minimum jednej stronie narzędzia.

Pozostałe parametry i skład zgodny z SWZ.

Zestaw zapakowany w opakowanie jednostkowe typu papier – folia lub folia-folia. Opakowanie jednostkowe zestawu zaopatrzone w minimum 2 metki samoprzylepne dwudzielne (jedna część w postaci kodu kreskowego), zawierające minimum: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Dot. części 4

Pozycje 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych zestawów do zmiany opatrunku o wysokiej odporności na penetrację płynów min 158 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i mokro min. 134 kPa o poniższym składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 8 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 5 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 45 x 37,5 cm

Opakowanie:

Opakowanie typu sztywny blister. * Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w jedną dwudzielną samoprzylepną metkę, jedna jej część w postaci kodu kreskowego, druga część zawierająca dane minimum: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu i listą komponentów w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Dot. części 4

Pozycje 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych zestawów do znieczulenia przewodowego o wysokiej odporności na penetrację płynów min 158 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i mokro min. 134 kPa. o poniższym składzie:

- 1 x serweta dwuwarstwowa epiduralna przylepna 60 x 75 cm, otwór przylepny typu romb 10 x 10 cm decentralnie
- 3 x kompres z włókniny o wymiarach 10 x 10 cm, 6 warstw, 30g/m²
- 6 x tupfer z gazy Nr 4, 24 x 24 cm, 20 nitek
- 1 x strzykawka 2 ml Luer, 2 części, biała z niebieskim tłokiem
- 1 x strzykawka 5 ml Luer, 2 części, biała z niebieskim tłokiem
- 1 x igła iniekcyjna 18G - 1,20 Gauge = mm (1,20 x 40 mm)
- 1 x igła iniekcyjna 25G, 0,50 x 40 mm
- 1 x kleszczyki plastikowe typu pean 14 cm
- 1 x serweta włókninowa dwuwarstwowa na stół narzędziowy 75 x 75 cm (owinięcie zestawu)

Zestaw zapakowany w opakowanie jednostkowe typu papier – folia lub folia-folia. Opakowanie jednostkowe zestawu zaopatrzone w minimum 2 metki samoprzylepne dwudzielne (jedna część w postaci kodu kreskowego), zawierające minimum: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Część nr 4 pozycja 1, 3,

Czy Zamawiający ze względu na komponenty wchodzące w skład zestawów i ich wykorzystanie do inwazyjnych procedur zabiegowych dłuższych niż 60 minut wymaga w tych pozycjach zaoferowania zestawów sklasyfikowanych jako wyrób medyczny w min. klasie IIA, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty deklaracji zgodności dla zaoferowanego wyrobu medycznego wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej, która musi uczestniczyć w ocenie zgodności tych produktów jako przedmiotowy środek dowodowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

WZÓR UMOWY – Załącznik nr 7 do SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące:

Dotyczy § 13 ust. 4. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20% łącznej wartości brutto towaru określonej w § 8 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Dot. części 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą dwuwarstwową na stół narzędziowy w kolorze niebieskim 50 x 75 cm wykonanej z pełnobarierowego dwuwarstwowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795:2019) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m². Serweta o wysokiej odporności na penetrację płynów min 200cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 170 kPa. (owinięcie zestawu), oraz w celu szybkiej identyfikacji zestawu dodatkowe owinięcie zestawu w postaci serwety polipropylenowej 50 x 75 cm o gramaturze 30 g/m² bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy w kolorze żółtym o odporności na penetrację płynów min 34 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho i mokro min 103 kPa. Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Część nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści klin stabilizujący o rozmiarach 45cmx45cmx60cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42

Część nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści klin stabilizujący o rozmiarach 20cmx20cmx46cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43

Część nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści klin stabilizujący o rozmiarach 23cm x 31cm x 56cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

Część nr 7, pozycja 3-7

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner wykonany ze 100% pianki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45

Część nr 7, pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści wałek o wymiarach 13cmx43cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46

Część nr 7, pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści półwałek o wymiarach 76cmx18cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Część nr 7, pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści ochraniacz pięt w jednym rozmiarze uniwersalnym bez pamięci kształtu pianki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Część nr 7

Czy Zamawiający dopuści pozycjonery bez pokrowca zewnętrznego, pakowanego w opak. foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

Część nr 7, pozycja 3-7

Czy Zamawiający dopuści pozycjonery bez pokrowca wewnętrznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Dot. projektu umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia dokumentu dostawy do faktury. Dokument dostawy jest generowany w magazynie znajdującym się poza granicami kraju w momencie wysyłki, w tym samym momencie generowana jest faktura w biurze w Warszawie i dostarczana Państwu na wskazany adres e-mail.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Dot. projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do poziomu 20% niewykorzystanej umowy brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający **zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:**

• **rozd. XV Przedmiotowe środki dowodowe pkt 7) i 8) SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

7) *Próbki oferowanych produktów należy złożyć/przesłać na adres: ul. Wawelska 15 B, 02-034 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, pokój 001 w terminie do dnia **04.09.2023 r. do godz. 09:00.***

8) *Próbki oferowanych produktów powinny być złożone w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym: „Próbki do postępowania na dostawę wyrobów medycznych, oznaczenie sprawy: PN-178/23/JP, część nrnie otwierać przed **04.09.2023 r. godz. 10:00**”*

• **rozd. XVI Wadium pkt. 2 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

*„Wadium w pieniądzu należy wnieść **do dnia 04.09.2023 r. do godz. 09:00** przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego (...)*”

- **rozdz. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **04.09.2023 r. do godz. 09:00**”

- **rozdz. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.09.2023 r. o godz. 10:00**”

- **rozdz. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **02.12.2023 r.**”

Pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe dopuszczenia oraz zmiany, podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioletta Dmowska

Załączniki:

- Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji,
- Zmieniony załącznik nr 2.8 do SWZ - formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia.