

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz elektrod igłowych jednorazowych**; Znak sprawy: PN-170/23/EP.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie nr 1: dot. część 5, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7mm łącznie, jednorazowego użytku, sterylne. Aktywowane ręcznie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem 360 stopni w obie strony, długość trzonu 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 20 mm, długość cięcia 18 mm, szczęki proste, kompatybilne z nowoczesnym generatorem, który zostanie udostępniony nieodpłatnie wraz z pełnym ubezpieczeniem serwisowym w ramach wartości umowy na czas jej trwania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2: dot. część 5, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7mm łącznie, jednorazowego użytku, sterylne. Aktywowane ręcznie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem 360 stopni w obie strony, długość trzonu 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 20 mm, długość cięcia 18 mm, szczęki zakrzywione typu Meryland, kompatybilne z nowoczesnym generatorem, który zostanie udostępniony nieodpłatnie wraz z pełnym ubezpieczeniem serwisowym w ramach wartości umowy na czas jej trwania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: dot. część 7, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny technologicznie trokar laparoskopowy tępy do wykonywania wstępnego dostępu, jednorazowego użytku, sterylne, długości 100mm lub 130mm (do wyboru przez Zamawiającego), średnicy 12mm z zintegrowanym systemem uszczelnień nie wymagający konwerterów do pracy z narzędziami od 4,7 do 13,2mm. System fiksacji kaniuli w powłokach złożony

z symetrycznego, bezlateksowego balonu o pojemności 20 ml oraz stożka żelowego, który w atraumatyczny sposób zamyka odnę i pozwala na bezpieczną artykulację narzędziami oraz nie ma możliwości nasiąkania jak pianka. Po bokach 2 opaski do szwów. Zintegrowany dwustopniowy zawór insuflacyjny. Całkowicie zdejmowalna głowica ułatwiająca usuwanie tkanki i szybką desuflację. Do zestawu dołączona strzykawka 20ml do napełniania balonu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 4: dot. część 7, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści Trokar laparoskopowy jednorazowego użytku, sterylny, 5-12 mm, bezpieczny o długości 100 mm z systemem redukcijnym, przeźroczysta kaniula żebrowana atraumatycznie; z zaokrąglonym, płaskim ostrzem i jednostronną osłoną. Informacja zwrotna dźwiękowa i wizualna o zabezpieczonym ostrzu podczas wprowadzania. Dwustopniowy zawór insuflacyjny, pozwalający na umiejscowienie go w trzech pozycjach (stop-insuflacja-stop). Całkowicie zdejmowalna głowica uszczelki ułatwiająca usuwanie tkanki i szybką desuflację pozabiegową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 5: dot. część 7, poz.3:

Czy Zamawiający dopuści Trokar optyczny jednorazowego użytku, sterylny, bezostrzowy z tępym przeźroczystym atraumatycznym obturatorem - separatorem tkankowym wyprofilowanym skrętnie o średnicy 15 mm, długości 100 mm, kaniula żebrowana atraumatycznie, przeźroczysta, dwustopniowy zawór insuflacyjny, pozwalający na umiejscowienie go w trzech pozycjach (stop-insuflacja-stop). Dodatkowo całkowicie zdejmowalna głowica uszczelki ułatwiająca usuwanie tkanki i szybką desuflację. System podwójnej uszczelki nie wymagający redukcji do pracy z narzędziami od 5 do 15mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 6: dot. część 7, poz.4:

Czy Zamawiający dopuści - Torebka laparoskopowa, jednorazowego użytku, sterylna, poliuretanowa o średnicy otworu ok. 6 x 9,6 cm i pojemności 225 ml, z elastyczną metalową obręczą i trzonem średnicy 10 mm, długości 29 cm, z samorozprężalną, ergonomiczną rękojeścią nożycową z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce. Woreczek dodatkowo wyposażony w koralik, pozwalający wielokrotne zamykanie i otwieranie woreczka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 7: Część 6, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę powrotną jednorazową dla pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 5 kg, z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 2,5 cm, wyposażoną w system kontroli jakości styku, kompatybilną z systemem REM generatora Valleylab, posiadającą żel zapewniający prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia 168 cm²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8: Część 6

W opisie Zamawiający określił szerokość styku na 4 cm. Ten standard połączenia z przewodem nie jest już stosowany; Prosimy o zmianę zapisu na 23 mm ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 9: część 7 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie trokara laparoskopowego, tępy do wykonania wstępnego dostępu, jednorazowego użytku, sterylny, długości 100 mm, średnicy 10 mm z wbudowanymi konwektorami dla narzędzi 5mm i 10mm, od wewnątrz fiksowany balonem (bez latexu) napełnionym powietrzem 10 ml i krążkiem piankowym od zewnątrz, strzykawka 20 ml do napełniania balonu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 10: część 7 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie torebki laparoskopowej, jednorazowego użytku, sterylnej, poliuretanowa o pojemności worka 200ml, 300ml, 800ml i 1350ml do wyboru przez Zamawiającego, z elastyczną metalową obręczą i trzonem średnicy 10 mm, długości ok.29cm, samorozprężalną, z ergonomiczną rękojeścią nożycową z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 11: Dotyczy Części nr 7: Pytanie dotyczy punktu 1:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, jednorazowego sterylnego trokara bezpiecznego o rozmiarze 10,5 mm, z obturatorem optycznym, który pozwala na bezpieczne wprowadzenie trokara pod kontrolą endoskopu. Mocowanie trokara odbywa się na przezroczystej karbowanej kaniuli o długości 110 mm. Trokar jest wyposażony w wbudowaną redukcję do stosowania narzędzi w rozmiarze 10 i 5 mm. Trokar posiada zdejmowaną głowicę do wygodnego wyjęcia próbek podczas zabiegu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 12: Dotyczy Części nr 7: Pytanie dotyczy punktu 2:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, jednorazowego sterylnego trokara bezpiecznego o rozmiarze 12,5 mm, z obturatorem z bezpiecznym chowającym się ostrzem. Mocowanie trokara odbywa się na przezroczystej karbowanej kaniuli o długości 110 mm. Trokar jest wyposażony w wbudowaną redukcję do stosowania narzędzi w rozmiarze 12, 10 i 5 mm. Trokar posiada zdejmowaną głowicę do wygodnego wyjęcia próbek podczas zabiegu. Trokar jest wyposażony w dwustopniowy zawór insuflacji (Start – Stop).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 13: Dotyczy Części nr 7: Pytanie dotyczy punktu 3:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, jednorazowego sterylnego trokara bezpiecznego o rozmiarze 5,5 mm, z obturatorem z bezpiecznym chowającym się ostrzem. Mocowanie trokara odbywa się na przezroczystej karbowanej kaniuli o długości 100 mm. Trokar jest wyposażony w dwustopniowy zawór insuflacji (Start – Stop).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 14: Dotyczy Części nr 7: Pytanie dotyczy punktu 4:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, torebki laparoskopowej, sterylnej, o pojemności 700 ml, z elastyczną metalową obręczą samorozprężalną i trzonem średnicy 10 mm, z ergonomiczną rękojeścią nożycową z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 15: Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z § 13 ust.1 pkt 1 do 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 16: Czy Zamawiający wydzieli i/lub dopuści do przetargu w pakiecie nr 7 poz.1

Jednorazowy trokar balonowy (bez lateksowy balon i miękki regulowany specjalny krążek „pierścienie” umożliwiający stabilną fiksację w powięziach) z bezpiecznym z trzpieniem i ostrzem, składający się z gładkiej optycznej kaniuli o długości 100mm, średnicy 10mm i trzpienia wyposażonego w płaskie ostrze w kształcie litery V aktywującego się tylko podczas oporu powłok. Trokar wyposażony w podwójny wskaźnik dźwiękowy i wizualny informujący o aktywacji noża oraz jego blokadzie po przejściu przez powłoki brzuszne, oraz w trójstopniowy zawór do insuflacji umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania drenu podającego CO₂ z opisanym i widocznym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. W zestawie strzykawka do napełnienia balonu mocującego. Całość wykonana z przeziernego tworzywa, pakowana w sterylnym opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 17: Czy Zamawiający wydzieli i/lub dopuści do przetargu w pakiecie nr 7 poz. poz.2.

Jednorazowy trokar laparoskopowy i długości (kaniula) 100mm z liniowym bezpiecznym nożem obustronnie ostrym, z wbudowanym wizualnym i dźwiękowym sygnalizatorem przejścia przez powłoki; karbowana kaniula; trzystopniowy zawór insuflacyjny (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2) samo dopasowującą się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12mm (bez konieczności używania redukcji). Całość wykonana z przeziernego tworzywa. Rozmiar średnicy trokara 5, 10, 12mm do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 18: Czy Zamawiający wydzieli i/lub dopuści do przetargu w pakiecie nr 7 poz. poz.3.

Jednorazowy trokar laparoskopowy średnicy 12mm i długości 100mm z liniowym bezpiecznym nożem obustronnie ostrym, z wbudowanym wizualnym i dźwiękowym sygnalizatorem przejścia przez powłoki; karbowana kaniula; trzystopniowy zawór insuflacyjny (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2) samo dopasowującą się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12mm (bez konieczności używania redukcji)?


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 19: Czy Zamawiający wydzieli i/lub dopuści do przetargu w pakiecie nr 7 poz. poz.4.

Worek do laparoskopii (endobag), jednorazowego użytku, sterylny, materiał worka poliuretan o średnicy 6,5cm i długości 18,5cm (do użytku przez trokar śred. 10 mm), z elastyczną metalową obręczą i trzonem średnicy 10 mm, długości

Lub

Worek ewakuacyjny do operacji laparoskopowych (endobag) z rękojeścią, worek z poliuretanu, obręcz z nici stalowej, stabilna ręczka, posiada pamięć otworu wyjściowego, wytrzymałość 5N/cm, wymiary $\varnothing$ 100 x 170 mm, trokar $\varnothing$ =10mm

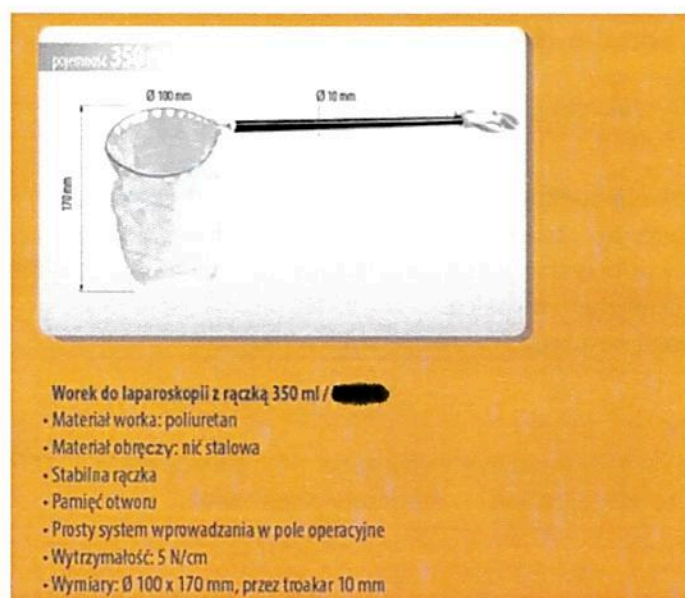

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 20: Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny technologicznie tępy trokar ze zintegrowanym systemem uszczelki nie wymagający konwerterów do pracy z narzędziami od 4,7 mm do 13,2 mm. System fiksacji kaniuli w powłokach złożony z symetrycznego, bezlateksowego balonu o pojemności 20ml oraz stożka żelowego, który w atraumatyczny sposób zamyka odmě i pozwala na bezpieczną artykulację narzędziami oraz nie ma możliwości nasiąkania jak pianka. Długość kaniuli 100 mm, w zestawie

strzykawka 20ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 21: Pakiet 7, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści Trokar jednorazowego użytku, sterylny, bezostrzowy z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym grotem w kształcie stożka z symetrycznie położonymi skrzydełkami oraz podłużnymi rowkami ślizgowymi umożliwiającymi łatwiejszą penetrację o średnicy 5-15 mm, długości 100 mm, kaniula żebrowana, przezroczysta, trójstopniowy zawór (insuflacja-stop-desuflacja)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 22: Pakiet 7, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści Trokar jednorazowego użytku, sterylny, bezostrzowy - optyczny z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym, z symetrycznie położonymi skrzydełkami o średnicy 5-15 mm, długości 100 mm, kaniula żebrowana, przezroczysta, trójstopniowy zawór (insuflacja-stop-desuflacja)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 23: Pakiet 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Torebke laparoskopową, jednorazowego użytku, sterylna, poliuretanowa o średnicy 6,5 cm i długości 15 cm, z elastyczną metalową obręczą i trzonem średnicy 10 mm, długości 28,5 cm, samorozprężalną, z ergonomiczną rękojeścią nożycową z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 24: Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – 1. Worek kriogeniczny 750 ml wraz z opakowaniem zabezpieczającym. Czy zamawiający dopuści pojemniki mrozeniowe o pojemności 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek o pojemności 500 ml. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 25: Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – 1. Worek kriogeniczny 750 ml wraz z opakowaniem zabezpieczającym. Czy zamawiający dopuści pojemniki o wymiarach 122x 220 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26: Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – 1. Worek kriogeniczny 750 ml wraz z opakowaniem zabezpieczającym. Czy zamawiający dopuści pojemniki o objętości mrozeniowej od 60 do 160 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o objętości mrozeniowej od 60 do 160 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ i dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 27: Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – 1. Worek kriogeniczny 750 ml wraz z opakowaniem zabezpieczającym. Czy zamawiający wymaga pojemników z trzema pojemnikami próbkowymi o objętości 1,5 ml każdy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

Pytanie nr 28: Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – 1. Worek kriogeniczny 750 ml wraz z opakowaniem zabezpieczającym. Czy zamawiający wyraża zgodę na opakowanie które zawiera 25 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze zawierające 25 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań. Jednocześnie zgodnie z SWZ worki mają być pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zabezpieczających.

Pytanie nr 29: Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – 2. Worek kriogeniczny 1000 ml. Czy zamawiający dopuści pojemnik mrozeniowy o objętości 650 ml pakowany sterylnie pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30: Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – 2. Worek kriogeniczny 1000 ml. Czy zamawiający wyraża zgodę na pojemnik o wymiarach 130 x 250 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ i dopuszczeniami wynikającymi z niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 31: Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – 2. Worek kriogeniczny 1000 ml. Czy zamawiający wyraża zgodę na pojemnik o objętości mrożeniowej 60 – 180 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32: Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – 2. Worek kriogeniczny 1000 ml. Czy zamawiający wymaga pojemników z jednym pojemnikiem próbkowym o objętości 1,5 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

Pytanie nr 33: Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – 2. Worek kriogeniczny 1000 ml. Czy zamawiający wyraża zgodę na opakowanie które zawiera 25 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 ustawy Pzp, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

- **Rozdz. XVI Wadium pkt. 2 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**
„Wadium w pieniądzu należy wnieść **do dnia 21.09.2023 r. do godz. 09:00** przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego (...)”
- **Rozdz. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **21.09.2023 r. do godz. 09:00**”
- **Rozdz. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.09.2023 r. o godz. 10:00**”
- **Rozdz. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**
„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **19.12.2023r.**”

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioletta Dmowska

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr Elżbieta Polkowska